

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ»
(ФБУ «РОСТЕСТ - МОСКВА»)

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ

№ СК 0048926

55526

Средство измерений Люксметр-яркометр-пульсметр RADEX LUPIN

Заводской № 000117

Изготовитель ООО "КВАРТА-РАД", г.Москва, Россия

Предназначенное для измерений освещенности, яркости, коэффициента пульсации

Наименование характеристики	Диапазоны измерений	Погрешность
Град-ка освещенности по источн. А	(10 ... 200000)лк	±10 %
Градуйровка яркости по источнику А	(10 ... 70000)кд/м2	±10%
Коэффициент пульсации	(1 ... 100) %	±10%

принадлежащее ООО "КВАРТА-РАД"

ИНН 7724195205

откалибровано по методике ГОСТ Р 8.665-2009


с применением эталонов: ГЭ силы света и освещенности непрер. изл
учения 0 р. по ГОСТ 8.023-2003

3.1.ZMA.0087.2013, аттестован до 03.03.2015

диапазон (35..500) кд, погр. ±0,3 %

Прослеживаемость к Государственному первичному эталону ГЭТ 5-03

Значения влияющих факторов ±21,1 С W= 50%

Начальник лаборатории № " 448 "  Квачев А.В.

Инженер по метрологии  Голованова В.А.


подпись

фамилия и о.

подпись

фамилия и о.

" 06 " февраля 2015

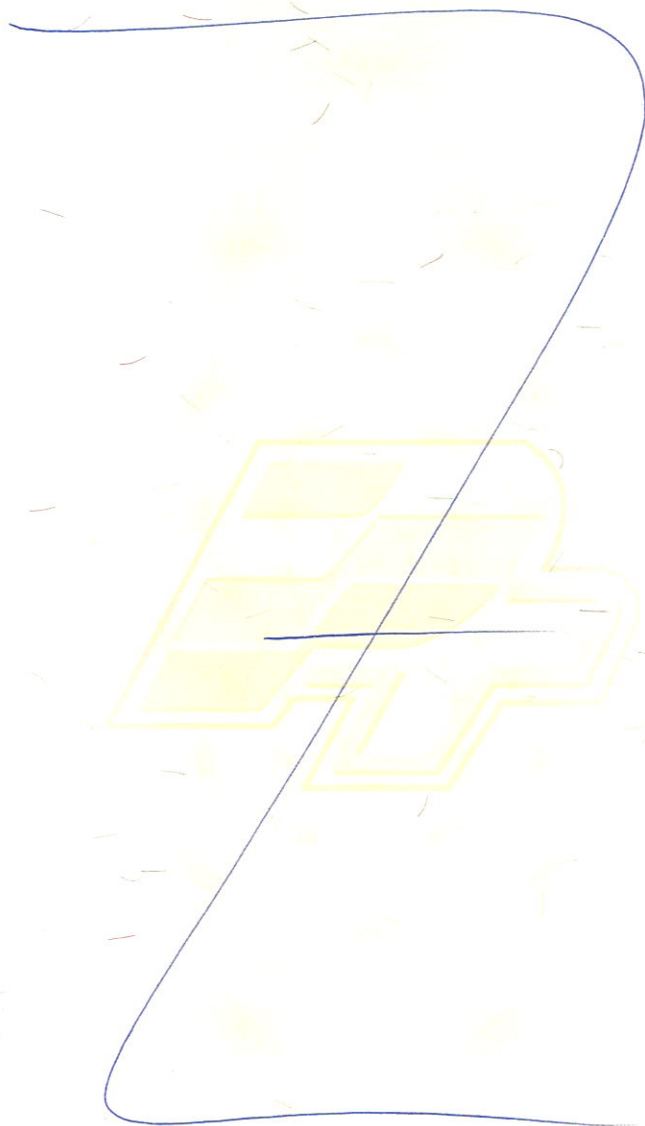

117418 Москва, Нахимовский пр., 31
Call-Центр: 495-544-00-00
тел. 499-129-19-11 факс: 499-124-99-96
Email: info@rostest.ru, www.rostest.ru

77